



MPGK - DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
PN/5/2019

Katowice, dnia 11.03.2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Obroki 140
40-833 Katowice

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: **Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Pytanie 1.

W związku z błędnie zadaniem pytaniem nr 9 prosimy o sprostowanie odpowiedzi:

Treść oryginalna:

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie Zamawiający pisze: "Pokrywy pojemników wyposażone w dwa otwory wrzutowe z daszkiem w pojemnikach na papier"

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 4-kołowe wyposażone w jeden otwór wrzutowy na papier o wymiarach minimalnych 500x100 i takie pojemniki dostarczał?

Powinno być:

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie trzecie Zamawiający pisze: "Pokrywy pojemników wyposażone w dwa otwory wrzutowe z daszkiem w pojemnikach na papier"

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 4-kołowe wyposażone w jeden otwór wrzutowy na papier o wymiarach minimalnych 500x100 i takie pojemniki dostarczał?

Stanowisko Zamawiającego Ad 1


Zamawiający czyni sprostowanie do pytania i odpowiedzi Nr 9 z dnia 06.03.2019 r.:

Treść pytania i odpowiedź „TAK, Zamawiający dopuszcza pojemniki 4-kołowe wyposażone w jeden otwór wrzutowy na papier o wymiarach minimalnych 500 mm x100mm ” dotyczy **zadania trzeciego**.

Pytanie 2.

W zamieszczonej na stronie internetowej odpowiedzi na pytanie nr12 dotyczącej wymiarów pojemnika zamawiający ustala bardzo wysoką tolerancję wykonania na poziomie +/-1,0mm dla wszystkich wymiarów pojemnika ze względu na ich obsługę eksploatowaną windą załadowniczą.

W związku z mocno ograniczonym dostępem do pojemników wg wymaganych wymiarów zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wykonania pojemników wg załączonego poniżej schematu:

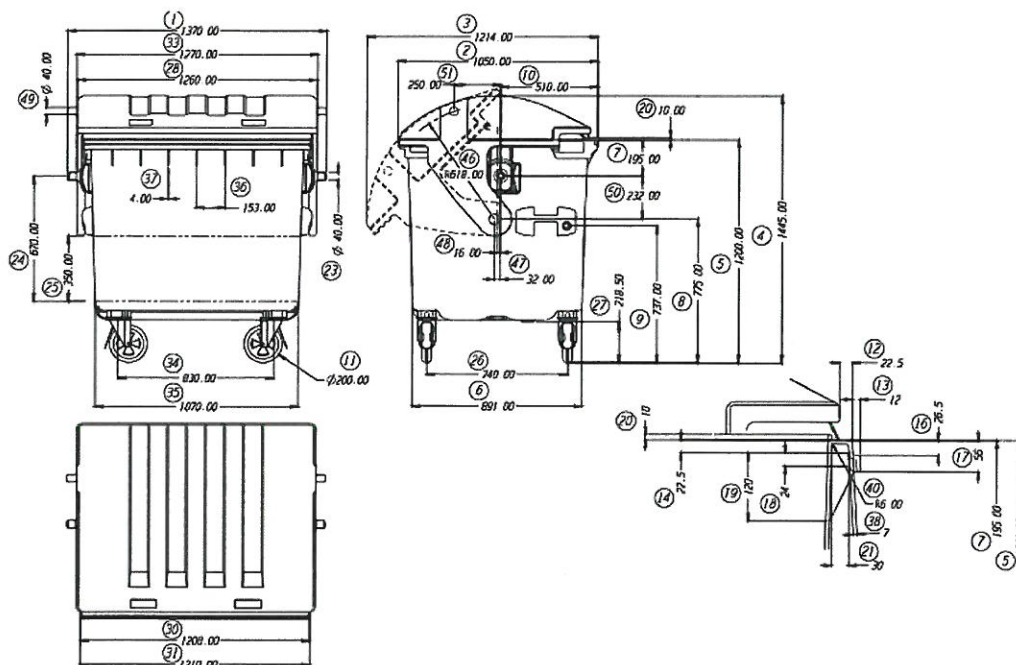

Stanowisko Zamawiającego Ad 2

Po ponownym przeanalizowaniu Zamawiający dopuszcza wykonanie pojemników (wymiary) zgodnie z powyższym schematem.

Pytanie 3.

Prosimy o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi dotyczącej wagi pojemnika (pyt 10). Wysoka jakość użytych materiałów znacząco wpływa na redukcję jego masy przy zachowaniu zakładanej ładowności.

Stanowisko Zamawiającego Ad 3

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie tj. nie dopuszcza zmiany wymaganej wagi pojemnika na odpady medyczne.

Ponadto Zamawiający uzupełnia odpowiedź do pytania Nr 13 z dnia 06.03.2019 r.:

Przytoczenie treści pytania:

„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje wymiary tłoczenia. Pole tłoczenia jest na tyle duże, że względy techniczne uniemożliwiają jego wykonanie.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące wymiary pola tłoczenia:

- pojemnik dwukołowy – max szerokość 240 mm, max wysokość 200 mm
- pojemniki czterołowe- max szerokość 550 mm, max wysokość 360 mm”

Stanowisko Zamawiającego :

TAK, Zamawiający dopuszcza

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla Wykonawców.

Zamawiający

Prokurent

Ilona Jarząbek
Ilona Jarząbek

V-CE PREZES ZARZĄDU

Robert Potucha
Robert Potucha